

# Rat TNF- $\alpha$ ELISA 试剂盒

产品编号# CRE0003 (48/96 孔)

适用于大鼠血清、血浆或细胞培养上清液等样本

仅供研究，不用于临床诊断。



客服热线: 400-7060-959 \* 技术支持邮箱: [tech@4abio.com](mailto:tech@4abio.com)  
公司官网: [www.4abio.net](http://www.4abio.net)

## 目录

简介 .....	- 3 -
检测原理 .....	- 3 -
试剂盒组分 .....	- 4 -
储存条件 .....	- 5 -
其他实验材料 (不提供, 但可协助购买) : .....	- 5 -
注意事项 .....	- 5 -
样本收集处理及保存方法 .....	- 6 -
试剂准备 .....	- 6 -
操作步骤 .....	- 8 -
操作流程图 .....	- 8 -
操作要点提示 .....	- 8 -
结果判断 .....	- 9 -
结果重复性 .....	- 9 -
灵敏度 .....	- 10 -
特异性 .....	- 10 -
参考文献 .....	- 10 -

 该产品由**北京四正柏生物科技有限公司**研制。

 请根据试剂盒中所附说明书指引进行实验。

## 简介

TNF- $\alpha$ 是一种主要由单核细胞和巨噬细胞产生的单核因子。1975年，Carswell等人发现卡介苗攻击小鼠后再用内毒素处理，小鼠血清中出现一种能诱导肿瘤组织出血坏死的物质，故命名为肿瘤坏死因子。1985年Shalaby把巨噬细胞产生的TNF命名为TNF- $\alpha$ ，把T淋巴细胞产生的淋巴毒素命名为TNF- $\beta$ 。

大鼠TNF- $\alpha$ 前体为235氨基酸残基，成熟的大鼠TNF- $\alpha$ 分子量为17kDa，由156个氨基酸残基组成，第69位和100位两个半胱氨酸形成分子内二硫键，有一个糖基化点，但糖基化不影响其生物学功能。鼠与人的TNF- $\alpha$ 有79%氨基酸组成同源性，TNF- $\alpha$ 的生物学作用无明显的种属特异性。

大鼠的TNF- $\alpha$ 是由活化的巨噬细胞及其它类型的细胞，包括T细胞和B细胞，NK细胞，LAK细胞，星形胶质细胞，内皮细胞，平滑肌细胞和某些肿瘤细胞产生。

TNF- $\alpha$ 的生物学活性非常复杂，包括对造血、免疫和炎症的调节；对血管和凝血的影响和对多种器官（肝、心脏、骨、软骨、肌肉和其它组织）的作用。

1)杀伤或抑制肿瘤细胞:TNF在体内、体外均能杀死某些肿瘤细胞或抑制其增殖。

2)提高中性粒细胞的吞噬能力，增加过氧化物阴离子产生，增强ADCC功能，刺激细胞脱颗粒和分泌髓过氧化物酶。

3)抗感染:如抑制疟原虫生长，抑制病毒复制、抑制病毒蛋白合成、病毒颗粒的产生和感染性，并可杀伤病毒感染细胞。TNF抗病毒机理不十分清楚。■

4)TNF是一种内源性热原质，引起发热，并诱导肝细胞急性期蛋白的合成。


5)促进髓样白血病细胞向巨噬细胞分化。

6)促进细胞增殖和分化:增强IL-2依赖的胸腺细胞、T细胞增殖能力。TNF- $\alpha$ 对某些肿瘤细胞具有生长因子的作用，并协同EGF、PDGF和胰岛素的促增殖作用，促进EGF受体表达。最近报道TNF- $\beta$ (LT)是EB病毒转化淋巴母细胞的自分泌生长因子，抗LT抗体、sTNF R以及TNF- $\alpha$ 能抑制EB病毒转化淋巴细胞的增殖。■

在临幊上，应用TNF在治疗肿瘤等方面开始临幊II期试验，也可与IL-2联合治疗肿瘤。TNF- $\alpha$ 的抗肿瘤作用包括TNF- $\alpha$ 的直接作用和TNF- $\alpha$ 诱导的针对肿瘤的免疫应答。TNF- $\alpha$ 参与包括哮喘，II型糖尿病，Crohn's病，和风湿性关节炎等疾病。TNF刺激内皮细胞，导致炎症、组织损伤和凝血从而诱发感染性休克。TNF还具有类似IFN抗病毒作用，阻止病毒早期蛋白质的合成，从而抑制病毒的复制，并与IFN- $\alpha$ 和IFN- $\gamma$ 协同抗病毒作用。

## 检测原理

本实验采用双抗体夹心ELISA。用抗大鼠TNF- $\alpha$ 单克隆抗体预包被酶标板，加入适度稀释的样本和标准品，其中的TNF- $\alpha$ 会与其单抗结合，洗去游离成分；加入生物素化的抗大鼠TNF- $\alpha$ 抗体，抗大鼠TNF- $\alpha$ 抗体与结合在单抗上的大鼠TNF- $\alpha$ 结合而形成免疫复合物，洗去游离的成分；加入辣根过氧化物酶标记的亲合素，生物素与亲合素特异性结合，洗去未结合的酶结合物；加入显色剂，若反应孔中有TNF- $\alpha$ ，辣根过氧化物酶会使无色的显色剂现蓝色；加终止液变黄。在450nm下测OD值，TNF- $\alpha$ 浓度与OD450值之间呈正比，可通过绘制标准曲线计算出标本中TNF- $\alpha$ 浓度。

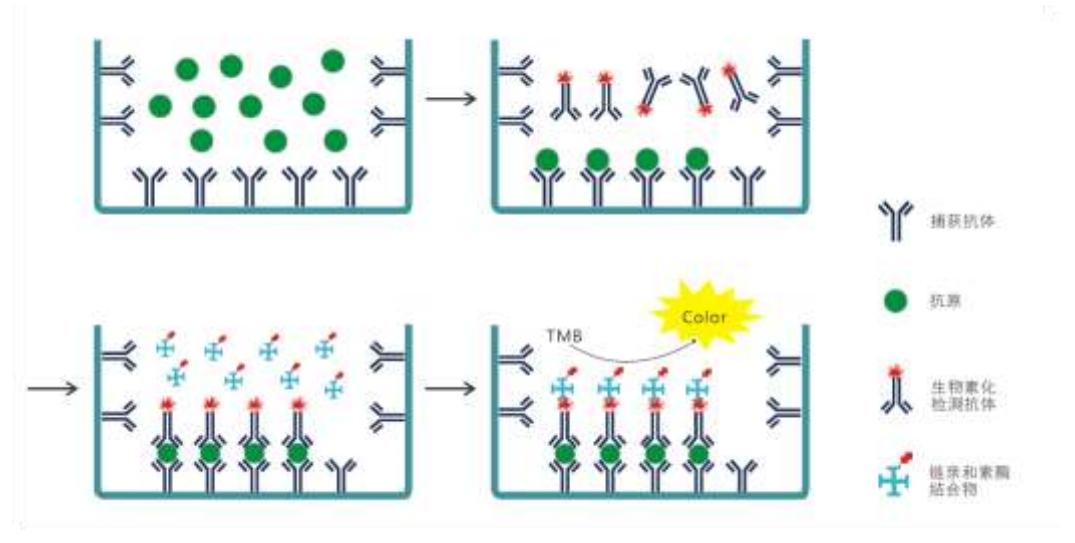

检测原理示意图

## 试剂盒组分

试剂盒组分	96 孔	48 孔	配制
1a 标准品	2 支	1 支	按说明书进行稀释
1b 标准品和标本稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
2a 浓缩生物素化抗体	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
2b 生物素化抗体稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
3a 浓缩酶结合物（避光）	2 支	1 支	按瓶签标识进行稀释
3b 酶结合物稀释液	1 瓶	1 瓶	即用型
4 浓缩洗涤液 20×	1 瓶	1 瓶	按瓶签标识进行稀释
显色剂（避光）	1 瓶	1 瓶	即用型
终止液	1 瓶	1 瓶	即用型
抗体包被板条	8×12	8×6	即用型
封板胶纸	4 张	2 张	即用型
说明书	1 份	1 份	

如果您收到试剂盒后发现上表中有任何组分破损或缺失,请及时联系我司客服 400-7060-959 或 [tech@4abio.com](mailto:tech@4abio.com)。我们将及时为您解决相关问题。

## 储存条件

未启封的试剂盒		4℃保存, 请于保质期内使用。	
已 启 封 或 重 新 溶 解 的 试 剂	1b 标准品和标本稀释液	可以整盒放入 4℃储存 1 个月。  2a 浓缩生物素化抗体 (100×) 2b 生物素化抗体稀释液 3a 浓缩酶结合物 (避光 100×) 3b 酶结合物稀释液 4 浓缩洗涤液 20× 显色剂 (避光) 终止液 标准品 抗体包被板条	2a 浓缩生物素化抗体和 3a 浓缩酶结合物需现用现配。  4℃或常温保存  重溶后分装, -20℃存放一个月, 避免反复冻融。稀释后的标准品使用后应丢弃, 不得重复使用。  实验中不用的板条应立即放回包装袋中, 密封干燥 4℃保存。
	2a 浓缩生物素化抗体 (100×)		
	2b 生物素化抗体稀释液		
	3a 浓缩酶结合物 (避光 100×)		
	3b 酶结合物稀释液		
	4 浓缩洗涤液 20×		
	显色剂 (避光)		
	终止液		
	标准品		

以上储存条件均要求在试剂盒保质期内。

## 其他实验材料 (不提供, 但可协助购买) :

1. 酶标仪(450nm)
2. 高精度可调移液器及吸头: 0.5-10, 2-20, 20-200, 200-1000μl; 一次检测样品较多时, 最好用多通道移液器。
3. 自动洗板机或洗瓶
4. 37℃温箱
5. 双蒸水或去离子水
6. 坐标纸
7. 量筒

## 注意事项

1. 试剂盒保存在2-8℃, 除复溶后的标准品, 其它成分不可冷冻。
2. 浓缩生物素化抗体(2a)、浓缩酶结合物(3a)装量极少, 运输中颠簸和可能的倒置会使液体沾到管壁或瓶盖。使用前请离心处理以使附着于管壁或瓶盖的液体沉积到管底。
3. 为避免交叉污染请使用一次性吸头。
4. 终止液和显色剂具腐蚀性, 避免皮肤及粘膜直接接触, 一旦接触到这些液体, 请尽快用大量水冲洗。
5. 使用干净的塑料容器配制洗涤液, 使用前充分混匀试剂盒里的各种成份及样品。
6. 洗涤酶标板时应充分拍干, 不要将吸水纸直接放入酶标反应孔中吸水。
7. 不要用其它来源的试剂混合或替代该产品的组分, 不同批号的试剂盒组份不能混用, 请在有效日期内使用本产品。

8. 在试验中标准品和样本检测时建议作双复孔或三复孔，加入试剂的顺序应一致，以保证所有反应孔孵育的时间一样。
9. 充分混匀对反应结果尤为重要，最好使用微量振荡器(使用最低频率进行振荡)。
10. 避免操作过程中酶标板干燥，干燥会使酶标板上生物成分迅速失活，影响实验结果。
11. 适当的稀释样品，使样品值落在标准曲线范围内，根据待测因子含量高、中、低的不同，建议采用1:100, 1:10, 1:2稀释样品。如果样品OD值高于最高标准，适当增加稀释度并重复检测。
12. 标准品稀释液、操作人、移液方式、洗涤方法、孵育时间及温度、试剂盒批次的不同均可能会导致结果的差异。
13. 此法可有效的消除可溶性受体、结合蛋白以及生物样品中的其他因素的干扰。

## 样本收集处理及保存方法


1. **血清**：使用不含热原和内毒素的试管，收集血液后，室温凝血30min， $1000\times g$ 离心10min，小心分离血清。
2. **血浆**：用EDTA、柠檬酸盐、肝素作为抗凝剂收集血浆，收集后30min内以 $1000\times g$ 离心15min去除颗粒。
3. **细胞上清液**： $1000\times g$ 离心10min去除颗粒和聚合物。
4. **保存**：若样品不立即检测，请将其按一次用量分装，-20℃—70℃保存，避免反复冻融。尽量避免使用溶血或高血脂样本。如果血清中含有大量颗粒，检测前先离心或过滤去除；室温下解冻，请勿于37℃或更高的温度加热解冻。
5. **稀释**：可根据实际情况，将标本做适当倍数稀释(建议做预实验，以确定稀释倍数)。

注：正常大鼠血清或血浆样本建议做1:2稀释。

## 试剂准备

1. 提前30min从冰箱中取出试剂盒，平衡至室温。
2. **洗涤缓冲液**：从冰箱中取出的浓缩洗涤液可能有结晶，这属于正常现象，加热并轻轻摇晃使结晶完全溶解后再配制。将浓缩洗涤液用双蒸水稀释(1:20)。未用完的放回4℃。
3. **标准品**：加入标准品/标本稀释液(1b)1.0ml 至冻干标准品(1a)中，待彻底溶解后，静置 15 分钟混匀(浓度为 2000pg/ml)，然后根据需要进行稀释，见下图(建议标准曲线使用以下浓度： 2000、1000、500、250、125、62.5、31.25、0 pg/ml)。稀释的标准品不得重复使用，未用完的标准品应按照一次用量分装后，将其放在-20～-70℃贮存，一次性使用，避免反复冻融。

**标准品稀释方法：**

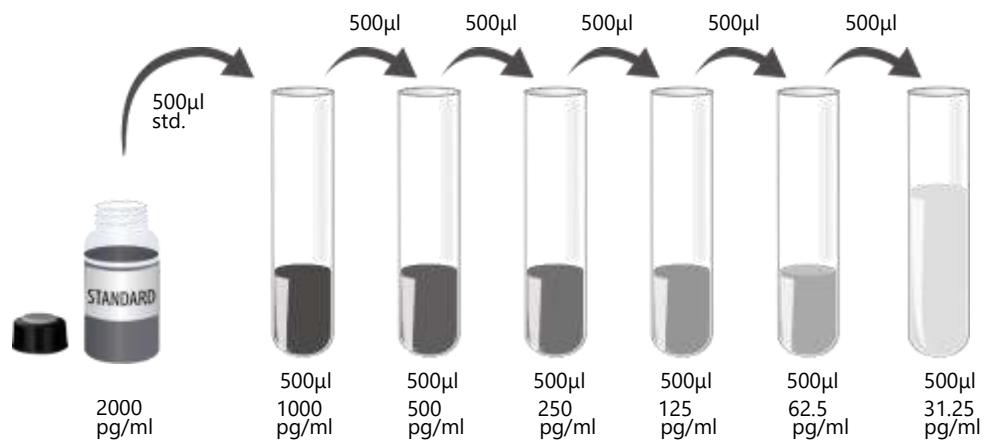

4. **生物素化抗体工作液：**根据每孔需要100μl来计算总的用量，多配制100-200μl。以生物素化抗体稀释液(2b)稀释浓缩生物素化抗体(2a)(1:100)。最好现用现配。(稀释方法见下表)

所用板条数	浓缩生物素化抗体	生物素化抗体稀释液
12	110μL	+ 10890μL
10	90μL	+ 8910μL
8	70μL	+ 6930μL
6	50μL	+ 4950μL
4	33μL	+ 3267μL
2	17μL	+ 1683μL
1	9μL	+ 891μL


5. **酶结合物工作液：**以酶结合物稀释液(3b) 稀释浓缩酶结合物(3a)(1:100)。最好现用现配。(稀释方法见下表)

所用板条数	浓缩酶结合物	酶结合物稀释液
12	110μL	+ 10890μL
10	90μL	+ 8910μL
8	70μL	+ 6930μL
6	50μL	+ 4950μL
4	33μL	+ 3267μL
2	17μL	+ 1683μL
1	9μL	+ 891μL

## 操作步骤

1. 按照上述准备工作配制好各种溶液。
2. 根据待测样品数量和标准品的数量决定所需的板条数，并增加1孔作为空白对照孔。分别将标本和不同浓度标准品(100 $\mu$ l /孔)加入相应孔中（零孔只加标准品/样本稀释液），用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育90分钟（空白对照孔除外）。
3. 洗板4次：(1)自动洗板机：要求注入的洗涤液为350 $\mu$ l，注入与吸出间隔15-30秒。(2)手工洗板：甩尽孔内液体，每孔加洗涤液350 $\mu$ l，静置30秒后甩尽液体，在厚迭吸水纸上拍干。
4. 加入生物素化抗体工作液(100 $\mu$ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育60分钟（空白对照孔除外）。
5. 洗板4次。
6. 加入酶结合物工作液(100 $\mu$ l /孔)。用封板胶纸封住反应孔，37℃孵箱孵育30分钟（空白对照孔除外）。
7. 洗板4次。
8. 加入显色剂100 $\mu$ l /孔，避光，37℃孵箱孵育10-20分钟。
9. 加入终止液100 $\mu$ l /孔，混匀后即刻测量OD450值(5分钟内)。

## 操作流程图

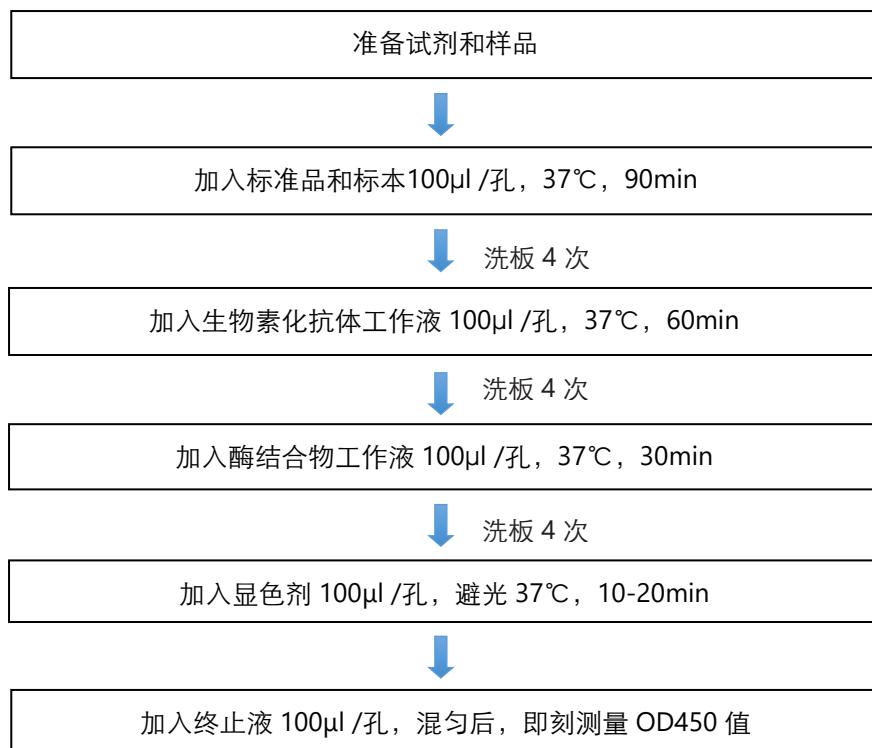

## 操作要点提示

1. 配制各种试剂时要充分混匀，但要避免产生大量泡沫，以免加样时加入大量的气泡，产生加样误差。
2. 为避免交叉污染，在加入不同浓度的标准品、不同样品、不同试剂时谨记及时更换吸头。
3. 为了确保准确的结果，在每次孵育前均需使用新封板胶纸封住反应孔。


4. 显色剂在添加之前，应保持无色，请勿使用已变为蓝色的显色溶液。最佳显色时间对标准曲线很重要，肉眼可见前3-4孔有梯度蓝色，后3-4孔差别不明显，零孔无蓝色出现即可终止。
5. 每次检测均要做标准曲线，根据样品待测因子的含量，适当稀释或浓缩样本，最好做预实验。

## 结果判断

1. 每个标准品和标本的OD值应减去空白孔的OD值，如果做复孔，求其平均值。
2. 使用计算机软件以吸光度OD值为纵坐标(Y)，相应的标准品浓度为横坐标(X)，生成相应的标准曲线，样品待检物含量可根据其OD值由标准曲线换算出相应的浓度。
3. 若标本OD值高于标准曲线上限，应适当稀释后重测，计算浓度时应乘以稀释倍数算标本含量。
4. 参考数据：

标准品浓度(pg/ml)	OD值1	OD值2	平均值	矫正值
0	0.065	0.053	0.059	---
31.25	0.211	0.205	0.208	0.178
62.5	0.273	0.283	0.278	0.255
125	0.390	0.395	0.393	0.395
250	0.626	0.623	0.625	0.641
500	1.020	1.027	1.024	1.051
1000	1.709	1.706	1.708	1.677
2000	2.510	2.505	2.508	2.516

数据仅供参考，不同用户最佳显色时间会有所不同

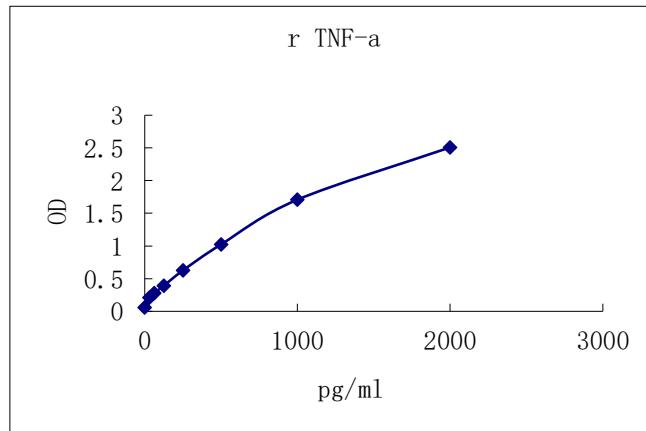

本图仅供参考，应以同次试验标准品所绘标准曲线为准

## 结果重复性

板间，板内变异系数均<10%。

## 灵敏度

最低检测大鼠 TNF- $\alpha$ 剂量小于 15pg/ml。 最低检出量测定方法：20 个零标准的平均 OD 值增加两个标准差，再计算相应的浓度。

## 特异性

此试剂盒可检测天然和重组的大鼠 TNF- $\alpha$ ，以 50ng/ml 平行做特异性试验，均不与下列细胞因子及蛋白反应。

重组大鼠细胞因子	重组人细胞因子	重组小鼠细胞因子
CINC-1	TNF- $\alpha$	TNF sRI
GDNF	TNF- $\beta$	TNF sRII
$\beta$ -NGF	TNF sRI	
PDGF-BB	TNF sRII	
IFN- $\gamma$		
IL-1 $\beta$		
IL-2		
IL-4		

## 参考文献

1. Kwon, J. et al. (1993) Gene 132:227.
2. Vilcek J. and T.H. Lee (1991) J. Biol. Chem. 266:7313.
3. Ware, C.F. et al. (1996) J. Cellular Biochemistry 60:47.
4. Tumor Necrosis Factor: Structure, Function and Mechanism of Action, Aggarwal, B.B. and J. Vilcek eds. (1991) Marcel Dekker, Inc., New York.
5. Beutler, B. and A. Cerami (1989) Annu. Rev. Immunol. 7:625.
6. Kwon, B. et al. (1999) Curr. Opin. Immunol. 11:340.
7. Idriss, H.T. and J.H. Naismith (2000) Microsc. Res. Tech. 50:184.
8. Sedgwick, J.D. et al. (2000) Immunol. Today 21:110.
9. Thomas, P.S. (2001) Immunol. Cell Biol. 79:132.
10. Saltiel, A.R. et al. (2001) Cell 104:517.
11. D'Haens, G. (2003) Curr. Pharm. Des. 9:289.
12. Feldmann, M. and R.N. Maini (2001) Annu. Rev. Immunol. 19:163.